



QFL 2343 - brometo de n-butila

Central Analítica USP

| Nome do pico | X | Y |
|--------------|---------|-------|
| 1 | 2961,16 | 76,2 |
| 2 | 2934,46 | 83,51 |
| 3 | 2874,54 | 88,03 |
| 4 | 1464,22 | 86,23 |
| 5 | 1438,21 | 90,43 |
| 6 | 1380,68 | 93,14 |
| 7 | 1294,97 | 93,53 |
| 8 | 1261,48 | 73,29 |
| 9 | 1215,87 | 78,95 |
| 10 | 1048,49 | 95,87 |
| 11 | 996,9 | 95,52 |
| 12 | 915,07 | 94,55 |
| 13 | 866,93 | 92,62 |
| 14 | 740,48 | 81,37 |
| 15 | 642,94 | 76,94 |
| 16 | 561,88 | 77,37 |

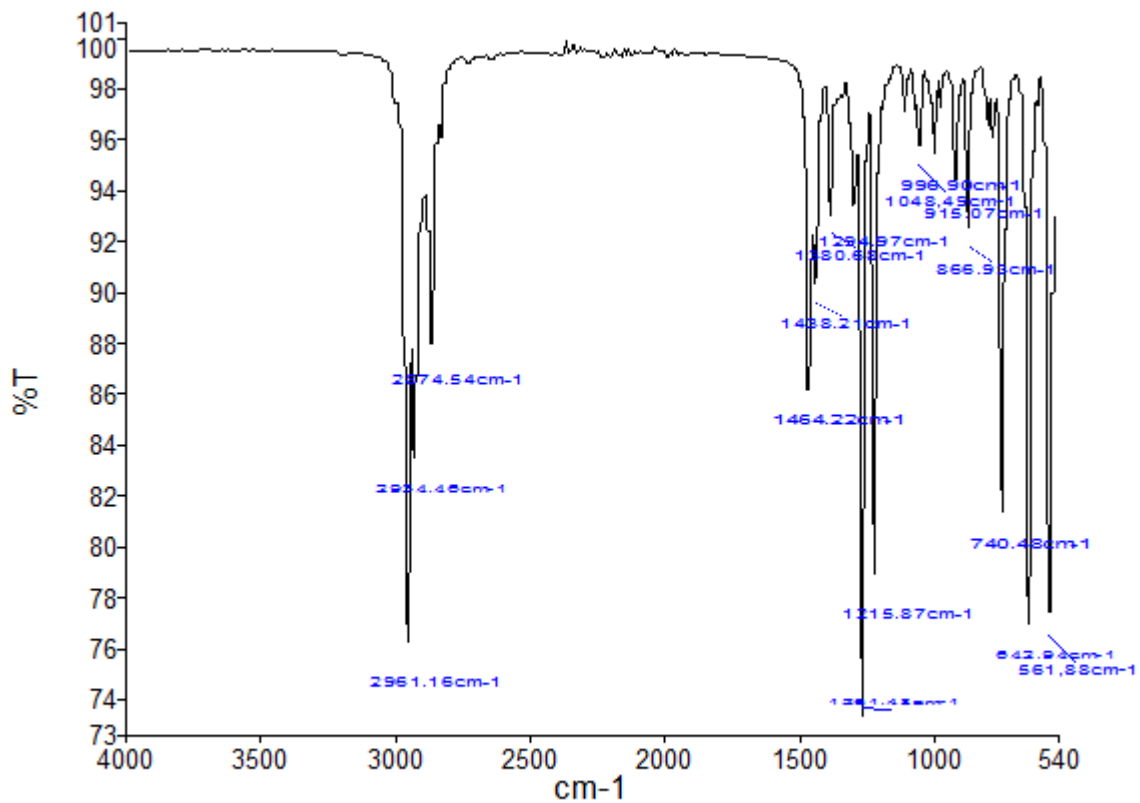

Nome Descrição
 QFL437T Brometo de n-butila

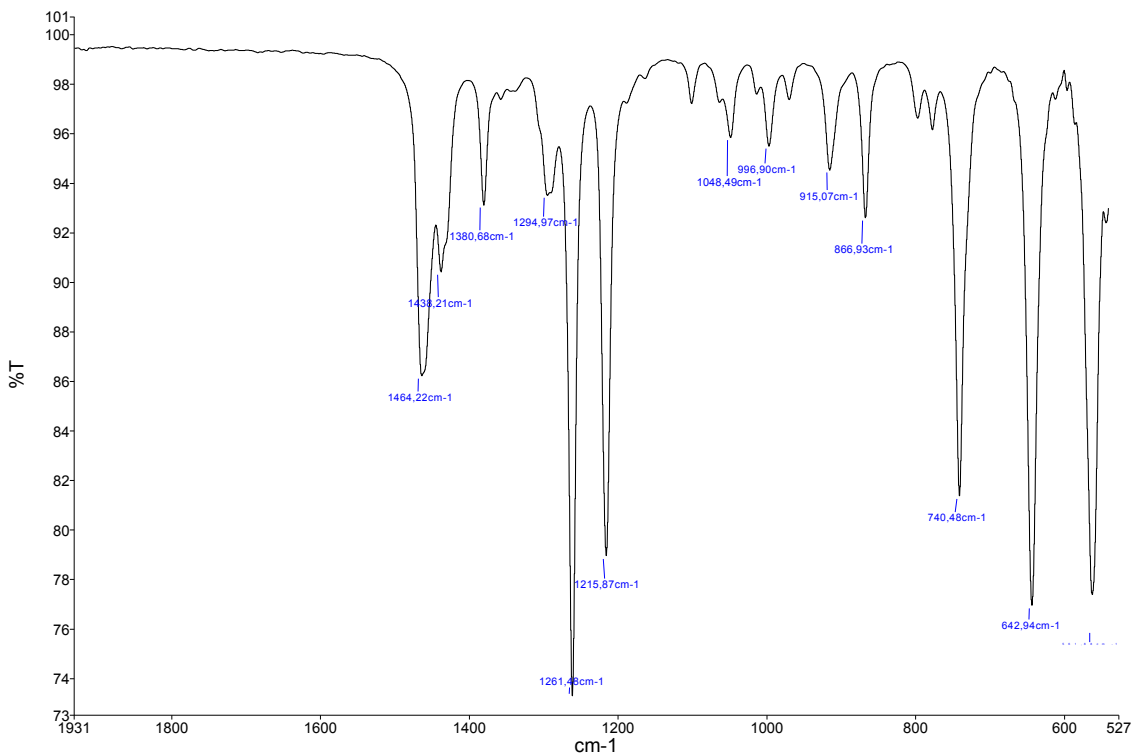

Nome Descrição
 QFL437T Brometo de n-butila